



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA
STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU

ul. Poleska 89, 15-874 Białystok
Tel. 85 66 37 301, fax. 85 66 37 302

www.wspr.bialystok.pl; sekretariat@wspr.bialystok.pl;

Białystok, 08.07.2021 r.

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu na dostawę
ambulansu neonatologicznego wraz
ze specjalistycznym sprzętem medycznym**

EOP.332.15.21

***DOTYCZY:** postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ambulansu neonatologicznego wraz ze specjalistycznym sprzętem medycznym.*

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z późn. zm.), w związku z prośbą o udzielenie wyjaśnień, dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności dwa fotele na prawej ścianie w przedziale medycznym bez fotela u wezglowia noszy co wiąże się też z rezygnacją szafki z półką w tylnej części ściany prawej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuści na lewej ścianie dwie płyty przesuwne do montażu defibrylatora i ładowarki baterii do niego oraz pompy infuzyjnej, natomiast respirator mocowany na stałej płycie na wysokości głowy pacjenta leżącego na noszach?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że inkubator oraz urządzenia medyczne stosowane w połączeniu z inkubatorem nie będą utrudniały dostępu do defibrylatora. Zamawiający przypomina, że przedmiotem zamówienia jest ambulans neonatologiczny wyposażony w inkubator i w związku z tym przewóz pacjentów w inkubatorze będzie podstawą jego zastosowania.

Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuści aby odczyt i regulacja temperatury w termoboxie odbywała się bezpośrednio z poziomu termoboxu a nie z panelu sterującego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4: Czy Zamawiający dopuści dwie anteny GPS/GSM na dachu ambulansu?

Odpowiedź:

W związku z faktem, że w/w anteny nie pasują do żadnych urządzeń wymienionych w SWZ, Zamawiający nie wymaga montażu anten GPS/GSM na dachu ambulansu.

Pytanie 5: Czy Zamawiający zrezygnuje z nakładania na Wykonawcę kar za opóźnienia w naprawie pojazdu bazowego? Wykonawca nie ma żadnego wpływu na czas naprawy pojazdu bazowego i trudno mu z tego powodu wziąć za to odpowiedzialność.

**Dział
Organizacyjno-Prawny**

Joanna Późniewska
Specjalista ds. organizacyjno-prawnych

85 66 37 344
przetargi@wspr.bialystok.pl

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA
STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU

ul. Poleska 89, 15-874 Białystok

Tel. 85 66 37 301, fax. 85 66 37 302

www.wspr.bialystok.pl; sekretariat@wspr.bialystok.pl;

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje kar za opóźnienie. Jednocześnie Zamawiający podtrzymuje treść SWZ w zakresie możliwości naliczenia kar za zwłokę w naprawie pojazdu bazowego. W przypadku gdyby przewidywany czas naprawy był dłuższy niż 30 dni, to wówczas Wykonawca ma możliwość wykazania, iż z przyczyn niezależnych termin ten nie może zostać dotrzymany. Jeżeli czas naprawy okaże się dłuższy i Wykonawca będzie potrafił to uzasadnić, Zamawiający nie naliczy kar za zwłokę.

Pytanie 6: W opisie przedmiotu zamówienia nie ma nic o instalacji sprężonego powietrza do zasilania inkubatora czy Zamawiający nie wymaga takiej instalacji?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie instalacji do sprężonego powietrza do zasilania o ile urządzenia stosowane w połączeniu z inkubatorem, w tym respirator wymaga zastosowania takiego rozwiązania. Wymagany sprzęt powinien funkcjonować i posiadać wszelkie instalacje niezbędne do jego prawidłowego działania.

Pytanie 7: Czy na zasadzie równoważności czujniki parkowania mogą być zamontowane przez autoryzowanego przedstawiciela producenta i być objęte fabryczną gwarancją pojazdu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8: Czy Zamawiający dopuści mocowanie kamizelki KED, deski dziecięcej i szyn Kramera zgodnie z homologacją wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9: Czy pakiet ubezpieczenia komunikacyjnego na 12 m-cy od wartości brutto musi dotyczyć wartości samego ambulansu czy też łącznie z pełnym wyposażeniem medycznym?

Odpowiedź:

Pakiet ubezpieczenia komunikacyjnego OC AC i NNW, zgodnie z punktem XV ppkt 5 załącznika nr 1 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia, dotyczy wyłącznie pojazdu (bez sprzętu medycznego).

Pytanie 10: Zamawiający rezerwuje sobie prawo do dokonania odbioru jakościowo – ilościowego ambulansu w ciągu 7 dni od daty dostawy, jednocześnie zapis umowy w §2, pkt. 2 mówi, iż na Wykonawcy spoczywa ryzyko utraty lub zniszczenia przedmiotu umowy. W związku z tym prosimy Zamawiającego o zmianę tego zapisu w sposób taki aby Zamawiający wziął odpowiedzialność za dostarczony ambulans do czasu jego odbioru jakościowo ilościowego lub aby taki odbiór odbył się nie później niż w dniu dostawy przedmiotu zamówienia, o którym Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego nie później niż na 7 dni przed tym terminem.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ. Zgodnie z § 3 ust. 2 projektu umowy, Wykonawca w cenę ofertową powinien wliczyć wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym należny podatek VAT, koszty dostawy oraz ubezpieczenia do momentu dokonania protokolarnego odbioru przedmiotu umowy (...).



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA
STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU

ul. Poleska 89, 15-874 Białystok
Tel. 85 66 37 301, fax. 85 66 37 302

www.wspr.bialystok.pl; sekretariat@wspr.bialystok.pl;

Pytanie 11: Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności zabudowę w tylnej części prawej ściany: „w świetle drzwi tylnych po stronie prawej przedziału medycznego przed fotelem bocznym szafka z nagrzewnicą wodną z mocowaniami (paski regulowane) na plecak lub torbę medyczną. Nad półką szafka zamykana roletą.”?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12: Z uwagi na wysoce specjalistyczny sprzęt medyczny opisany w SIWZ oraz jego kompletację w połączeniu z noszami z zasilaniem elektrycznym prosimy Zamawiającego o wyodrębnienie sprzętu medycznego na osobny pakiet.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ. Z uwagi na wysoce specjalistyczny sprzęt medyczny, który musi współpracować ze sobą oraz być kompatybilny z instalacjami będącymi integralną częścią ambulansu, jedynie wykonawca całego zamówienia jest w stanie przeprowadzić czynności instalacyjno-montażowe w sposób spójny i skoordynowany tak aby cały sprzęt działał prawidłowo. Powody niedokonania podziału zamówienia na części zostały wskazane również w punkcie IV ppkt 3 SWZ.

Pytanie 13: Czy Zamawiający wymaga aby mocowanie pacjenta na materacu spełniało normę EN 1789:2007+A2:2014 oraz EN 13976-2:2018 i było dostępne w trzech rozmiarach S,M,L?



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 14:

Czy Zamawiający wymaga aby „cieplarka” posiadała wbudowaną akumulator umożliwiającą poprawność działania / zasilania przez okres nie krótszy niż 180 min?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga..

Pytanie nr 15

Prosimy o akceptację dla rozwiązania które dzięki wybudowanej baterii wewnętrznej zapewnia i gwarantuje utrzymanie zasilania przez 180 min kapsuły inkubatora? Montaż dodatkowych baterii zasilających wpływa bezpośrednio na wagę całego zestawu transportowego zaś każdy z elementów wyposażenia posiada swoje wewnętrzne baterie gwarantujące prawidłowe działanie osprzętu peryferyjnego?



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA
STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU

ul. Poleska 89, 15-874 Białystok

Tel. 85 66 37 301, fax. 85 66 37 302

www.wspr.bialystok.pl; sekretariat@wspr.bialystok.pl;

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający wymaga modułu zasilania sprzętu medycznego wbudowanego wewnątrz inkubatora transportowego wraz z opornikami który gwarantuje zasilanie 230V i ładowanie akumulatorów/baterii poprzez jeden kabel np. w karetce.


Nie powinno się dopuścić rozwiązania bazującego na zamontowaniu tradycyjnych listew zasilających jak również gniazd elektrycznych które nie spełniają normy transportowych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający wymaga aby sterownik nawilzacza był zintegrowany z obudową inkubatora w jego podstawie co gwarantuje możliwość dostosowania ustawień względem trybu wentylacji?

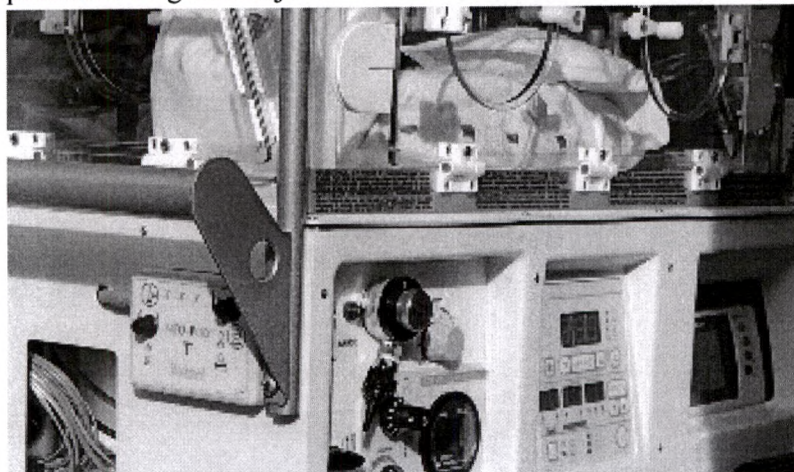

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający wymaga aby komora nawilzacza transportowego miała pojemność 60 ml wody co zabezpiecza przed „przelaniem” się nadmiaru wody do układu oddechowego podczas wentylacji pacjenta?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający wymaga aby platforma do której jest zamocowany sprzęt medyczny wraz z inkubatorem posiadała otwory techniczne które w przyszłości umożliwią rozbudowę zestawu transportowego o kolejne elementy wyposażenia medycznego jak na przykład urządzenie do podaży tlenu azotu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 20

f

JJM 29 M



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA
STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU

ul. Poleska 89, 15-874 Białystok
Tel. 85 66 37 301, fax. 85 66 37 302

www.wspr.bialystok.pl; sekretariat@wspr.bialystok.pl;

Czy Zmawiający wymaga aby butle gazowy były zamontowane pod cieplarką?

Takie rozwiązanie gwarantuje odpowiednie rozłożenie środka ciężkości zaś z drugiej strony umożliwia odpowiednie rozłożenie pozostałego sprzętu

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 21

Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgodny na wydzielenie z pakietu pozycji nr XVI – Wyposażenie medyczne: Inkubator transportowy wraz z osprzętem i transporterem.

Zgodnie z opisanym wymogiem SIWZ „IV. Opis przedmiotu zamówienia pkt. 3” obiór zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, nie wyklucza podziału przedmiotu dostawy na dwa odrębne pakiety tj. pojazd i wyposażenie medyczne, co nie powoduje dla Zamawiającego żadnych trudności technicznych jak i organizacyjnych, ponieważ to na Wykonawcy ciąży obowiązek należytego wywiązania się z kontraktu.

Dostawę odbiera Zamawiający i ma pełne prawo w przypadku jakichkolwiek niezgodności do żądania ich usunięcia przez Wykonawcę z wypowiedzeniem umowy włącznie.

Dotychczasowy zapis SIWZ nakładający wymóg złożenia oferty na całość postępowania, powoduje sztuczne podwyższenie cen, zmuszając Oferentów do zawierania konsorcjów oraz subdystrybucji produktów, których asortyment pokrywa różnorodne dziedziny szeroko pojętego transportu jak i sprzętu medycznego.

Podział przetargu na w/w pakiety, zapewni Zamawiającemu udział w przetargu bezpośrednich importerów i dystrybutorów, bez udziału podwykonawców i pośredników, jednocześnie gwarantując:

- możliwość zakupu lepszych jakościowo produktów,
- uzyskanie niższych cen, zezwalając na konkurencję cenową szerszemu gronu oferentów,
- oszczędne i efektywne wydatkowanie środków publicznych:
 - a). art. 44 ustawy o finansach publicznych,
 - b). ustawa PZP Dz.U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 ze zm.,
 - c). druk sejmowy Nr 2218.
- gwarancję oraz serwis autoryzowanego przedstawiciela,
- terminową realizację umowy,
- konkurencyjność cenową przy wyborze wykonawców, niedyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia oraz równy dostęp wykonawców

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ. Z uwagi na wysoce specjalistyczny sprzęt medyczny, który musi współpracować ze sobą oraz być kompatybilny z instalacjami będącymi integralną częścią ambulansu, jedynie wykonawca całego zamówienia jest w stanie przeprowadzić czynności instalacyjno-montażowe w sposób spójny i skoordynowany tak aby cały sprzęt działał prawidłowo. Powody niedokonania podziału zamówienia na części zostały wskazane również w punkcie IV ppkt 3 SWZ.

Pytanie nr 22: Czy Zamawiający oczekuje aby oferowany inkubator umożliwił pełen dostęp do pacjenta „od góry” po otwarciu kopuły inkubatora?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 23: Czy Zamawiający oczekuje aby dostarczony inkubator posiadał konstrukcję, która skutecznie pochłaniać będzie wibrację (a nie stabilizować przemieszczanie się noworodka) podczas transportu tj. drgania nie będą przenoszone na pacjenta?

Odpowiedź:



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA
STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU

ul. Poleska 89, 15-874 Białystok

Tel. 85 66 37 301, fax. 85 66 37 302

www.wspr.bialystok.pl; sekretariat@wspr.bialystok.pl;

Zgodnie z pkt XVI. ppkt 1. Opisu Przedmiotu Zamówienia, Inkubator z systemem pochłaniającym wibracje podczas transportu pacjenta w ambulansie jak i podczas transportu poza ambulansem jest parametrem niewymaganym, dodatkowo punktowanym.

Pytanie nr 24: Czy Zamawiający oczekuje zaoferowanie inkubatora transportowego (zestawu transportowego) w którym poziom hałasu nie przekracza dozwolonych norm głośności tj. 45 dBA?

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią SWZ. Maksymalny poziom hałasu został określony w normach wyszczególnionych w zał. nr 1 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 25: Dotyczy załącznik nr 1 - pkt. I.1 - prosimy o dopuszczenie następującego rozwiązania dotyczącego technologii wyłożenia ścian: "Ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi płytami z tworzywa sztucznego w kolorze białym zapewniającymi wysoki poziom higieny w przedziale medycznym."

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 26: Dotyczy załącznik nr 1 - pkt. I.13 - prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie wymaga dodatkowych uchwytów w schowku na np. butle powietrzne, butlę tlenu azotu, kompresor itp.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie pod warunkiem że respirator nie wymaga zastosowania dodatkowych uchwytów.

Pytanie nr 27: Dotyczy załącznik nr 1 - pkt.II.2 - z uwagi na zmianę modelową oraz trudną dostępność samochodu z podaną mocą prosimy o dopuszczenie samochodu z silnikiem o mocy 130 kW.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 28: Dotyczy załącznik nr 1 - pkt.VII.3 - prosimy o dopuszczenie montażu tego systemu na etapie adaptacji na ambulans.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 29: Dotyczy załącznik nr 1 - pkt. IX. 6 - czy Zamawiającemu chodzi i błotniki przedni czy tylne czy te i te.

Odpowiedź:

Zapis dotyczy błotników przednich.

Pytanie nr 30: Dotyczy załącznik nr 1 - pkt.XI.5 - prosimy o podanie wymiarów deski ortopedycznej dziecięcej będącej na wyposażeniu Zamawiającego.

Odpowiedź:

Na wyposażeniu Zamawiającego znajduje się deska ortopedyczna PEDIPAC FERNO.

Pytanie nr 31: Dotyczy załącznik nr 1 - prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie wymaga lawety? Nosze mają być montowane na podłodze? Jako ambulans neonatologiczny nie powinna być zastosowana laweta pneumatyczna?

Odpowiedź:

Zamawiający nie precyzuje czy wymaga lawety ani jakiego rodzaju ma ona być.



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA
STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU

ul. Poleska 89, 15-874 Białystok
Tel. 85 66 37 301, fax. 85 66 37 302

www.wspr.bialystok.pl; sekretariat@wspr.bialystok.pl;

Pytanie nr 32: Dotyczy załącznik nr 1 - prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie wymaga instalacji powietrznej - np. gniazd, mocowanie butli, sprężarki, itp.?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby instalacja była dostosowana do modelu zaferowanego respiratora – jeżeli respirator wymaga instalacji powietrznej, powinna ona się znajdować na wyposażeniu ambulansu.

Pytanie nr 33: Dotyczy załącznik nr 1 - czy Zamawiający dopuści dwa fotele na ścianie prawej zamiast jednego fotela u węzłowia noszy oraz jednego fotela na prawej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. W przypadku zastosowania takiego rozwiązania, Zamawiający rezygnuje z szafki z półką w tylnej części ściany prawej (podobnie – pytanie i odpowiedź nr 1).

Pytanie nr 34: Dotyczy załącznik nr 1 - pkt. I.13 - prosimy o potwierdzenie, iż butle z reduktorami nie są przedmiotem w postępowaniu i Wykonawca ma przygotować tylko miejsce pod nie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga dostarczenia butli z reduktorami. Wymagane jest przygotowanie miejsca na butle z reduktorami.

Pytanie nr 35: W celu testowym - prosimy o możliwość dostawy ambulansu na kołach, a nie na lawecie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ nie powodują zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

UWAGA: Prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma emailem: przetargi@wspr.bialystok.pl

DYREKTOR
SP ZOZ WSFR w Białymstoku

lek. med. Bogdan Kalicki